

Sistema Sanitario Regionale Piemonte
Azienda Ospedaliera Nazionale
**SS. ANTONIO e BIAGIO
e CESARE ARRIGO**
Alessandria

Sede legale: via Venezia n.16 - 15100 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111. Telefax: (0131) 236227

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 400

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di aprile in una sala degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" - via Venezia, 16 - 15100 Alessandria

IL DIRETTORE GENERALE


DOTT.SSA GIOVANNA BARALDI

ai sensi della D.G.R. n.42 - 1370 del 27/04/2015

Acquisito il parere del - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - dott. Francesco ARENA
- DIRETTORE SANITARIO - dott.ssa Paola COSTANZO

adotta la deliberazione all'oggetto indicato:

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA, IN AMBITO EUROPEO, PER LA FORNITURA QUINQUENNALE, IN SERVICE, DI NR. 2 SISTEMI PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, COMPENSIVI DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA, PER LA S.C. CARDIOCHIRURGIA. GARA ANAC N. 6579116.



DELIBERAZIONE N. 400 DEL - 5 APR. 2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA, IN AMBITO EUROPEO, PER LA FORNITURA QUINQUENNALE, IN SERVICE, DI NR. 2 SISTEMI PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, COMPENSIVI DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA, PER LA S.C. CARDIOCHIRURGIA. GARA ANAC N. 6579116.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 384 del 28/03/2017 della S.C. Acquisti e Servizi Economici dalla cui istruttoria si evince che:

“VISTA la Deliberazione DG. n. 152 del 03/02/2017 ad oggetto: “*Deliberazione n. 1479 del 23.12.2016 – rettifica regolamento per l'adozione degli atti amministrativi e dei provvedimenti aziendali, ed individuazione responsabili del procedimento in attuazione al vigente atto aziendale*”;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” che disciplinano la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO che:

- con Deliberazione DG n. 1457 del 23/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura quinquennale, in service, di nr. 2 sistemi per la circolazione extracorporea per la S.C. Cardiochirurgia, comprensivi del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica, da aggiudicare, a lotto unico, all'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione qualitativa da effettuarsi da parte di un'apposita commissione giudicatrice, prevedendo l'importo a base d'asta pari a Euro 925.000,00 (IVA esclusa), comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con la Deliberazione DG n. 1457/2016 sopra citata, sono stati approvati i seguenti documenti:

- ✓ Capitolato di gara e relativi allegati;
- ✓ bando integrale di gara;
- ✓ estratto del bando di gara;

e si disponevano, altresì, le modalità di pubblicazione degli avvisi legali di gara:

§ bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici, sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

§ estratto del bando di gara su “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; Italia Oggi; Il Giornale del Piemonte, La Stampa – ediz. Alessandria;

- gli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria;

- l'aggiudicazione della fornitura è prevista, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante attribuzione degli elementi di valutazione sotto riportati:

3	10-81-30	Clamp tubi "Variolock" S5 RP150 (comprende 1 x 10-61-72 e 1 x 10-61-73)
1	10-84-60	S5 vassoio per pompa roller RP150
1	10-84-64	S5 vassoio per 2 pompe roller RP150
1	50-80-60	S5 2 pompe roller a stativo 85 (S5 MRP85) comprensive di fissaggio a stativo per 2 MRP85 e pannello di controllo
1	60-00-60	Sistema cp5, comprende i codici: 60-01-00, 60-02-50, 60-01-50, 96-414-120
1	28-95-01	S5 pannello di sistema da 5 display
5	28-95-10	S5 Modulo di controllo e display
1	22-20-20	S5 modulo sensore di pressione (2-canale)
3	45-04-03	Trasduttore di pressione MEDEX MX 960 LogiCal
3	45-04-15	Cavo di connessione per trasduttore di pressione
2	45-04-16	Supporto per un trasduttore di pressione
1	45-04-17	Supporto per 2 trasduttori di pressione
1	21-15-00	S5 Timer (3 canali), compresi nell'unità di base
1	20-30-20	S5 Modulo sensore temperatura (4 canali) per sonde YSI
2	042229000	Sonda di temperatura YSI per ossigenatori
1	23-40-00	S5 Modulo sensore di livello che comprende: 23-27-40 e 23-27-41
1	23-45-00	S5 Modulo sensore di bolle, incl. 23-07-45, 23-26-96 e 96-06-10
1	27-80-20	S5 Modulo sensore cardioplegia
1	96-490-042 ITA	Gas Blender meccanico Sechrist, Air+O2, FIO2
1	12-80-00	S5 Occlusore Venoso Elettrico (EVO), completo, che comprende:
1	35-05-70	S5 Lampada a led
1	24-90-80	Connect Recorder per S5/C5 (SW e Licenza - interfaccia, Data Pad, supporto e cavi)

per il funzionamento dei due sistemi gestione dati, sarà fornito il seguente software:

1	24-90-45	Connect Manager (solo SW)
---	----------	---------------------------

n. 2 gruppi caldo-freddo, nuovi di fabbrica, MOD. 3T, ciascuno composto da:

1	16-02-80	Gruppo caldo freddo 3T (230 VOLT) con cavo 6 m (45-12-01) per connessione a S5
1	16-10-10	Raccordi per materassino
1	16-10-55	Tubing set for heating-cooling blankets
3	196CPC	Blanket
4	09028	Attacco Hansen femmina
4	09029	Attacco Hansen maschio
20	09035	tubo retinato

Costo annuo complessivo della fornitura (fornitura del sistema comprensivo di manutenzione e materiale di consumo: € 182.040,00 (IVA esclusa)

Costo totale della fornitura per 5 anni: € 910.200,00 (IVA esclusa)

Tempi di consegna sistemi e materiale di consumo: sistemi per circolazione extracorporea: 4 settimane data aggiudicazione; materiale di consumo: pronta e/o su vs. richiesta;

PRECISATO che:

- ai sensi del disposto di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale di gara, l'importo della cauzione definitiva da richiedere all'impresa affidataria della presente fornitura (calcolata sul 10% dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa) risulta determinato come segue :

DITTA	IMPORTO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA	CAUZIONE DEFINITIVA	MODALITA' STIPULA CONTRATTO
LIVA NOVA - SORIN GROUP ITALIA SRL	€ 910.200,00	€ 91.020,00	Scrittura privata

- l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto qualora l'impresa sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 per le garanzie provvisorie ed applicabili anche a tale tipologia di polizze;
- l'aggiudicazione definitiva della presente gara diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti generali di partecipazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, a carico dell'unico soggetto contraente mediante acquisizione della documentazione a comprova delle autocertificazioni presentate in fase di ammissione mediante l'utilizzo del sistema AVCpass, tramite il PASSOE;
- la stipula del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del provvedimento non trovando applicazione nella fattispecie la clausola di sospensione (cd. "standstill o termine dilatorio) prevista dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
- questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano attive convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto, né contratti di fornitura derivanti dall'effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale (S.C.R. Spa);
- per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di riferimento elaborati dall'ANAC relativi ai beni oggetto del presente provvedimento;
- la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara approvato con la deliberazione DG n. 1457/2016 sopra richiamata;
- alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. 6875789095 da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la spesa derivante dall'affidamento della fornitura in oggetto, pari a complessivi € 910.200,00 (I.V.A. esclusa), verrà contabilizzata sui competenti conti di bilancio aziendale per quanto concerne la fornitura del materiale di consumo dedicato ai sistemi diagnostici in oggetto, il servizio di manutenzione di tipo "Full Risk con apparecchiatura critica sostitutiva" dei sistemi installati, l'aggiornamento hardware/software delle strumentazioni e l'attività di formazione del personale, e suddivisa negli esercizi di competenza, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo delle apparecchiature che verrà effettuato secondo le modalità indicate all'art. 16 del capitolato speciale di gara ("Consegna, installazione, collaudo e corso di formazione



delle apparecchiature”);

RICHIAMATO l'art. 98 del D Lgs. 50/2016 che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico, di invio di un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato su “La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” e su “La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” e dell'estratto dell'avviso sui quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (inserzione gratuita); Italia Oggi; Il Giornale del Piemonte, Il Piccolo, sulla base del preventivo nr. AR-0271/17 del 28/03/2017, depositato agli atti della S.C. proponente, predisposto dalla Ditta CSA MED srl di Cremona (a seguito di adesione alla Convenzione stipulata da SCR Piemonte per il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali - gara 7/2016) per un importo complessivo di € 862,23 (comprensivo di bolli) IVA esclusa, che sarà posto a carico della stazione appaltante sul conto economico 3.10.04.50 “pubblicità su quotidiani e periodici”

DATO ATTO che l'esito di gara verrà, inoltre, pubblicato sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici e sul profilo del Committente di questa Stazione Appaltante (www.ospedale.al.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantirne la massima pubblicità;

RILEVATA la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento per assicurare il completo e corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 28, c. 2. L.R. n. 10 del 24.01.1995.”

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

ACQUISITO il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Sanitario nonché quello favorevole del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il verbale redatto in seduta pubblica in data 20/03/2017 (allegato al presente provvedimento quale parte integrante) relativo all'aggiudicazione provvisoria, a seguito di esperimento di procedura aperta comunitaria, della fornitura quinquennale, in service, di nr. 2 sistemi per la circolazione extracorporea per la S.C. Cardiochirurgia, comprensivi del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica - C.I.G. 6875789095;
2. DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, la fornitura in oggetto in capo alla ditta sotto indicata in base alle condizioni economiche descritte nell'offerta allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
LIVA NOVA – SORIN GROUP ITALIA SRL, Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO)

Offerta nr. 10/2017 del 24/01/2017

N. 300/anno

Ossigenatori a fibre cave per adulti
cod. 050714 MOD. INSPIRE 8

confezionamento n. 2 pz. per confezione
 numero confezioni per anno: n. 150 confezioni per anno
costo unitario Euro 287,72/cad. +IVA 22%
 costo a confezione Euro 575,44/+IVA 22%
 codice CND C03010102
 RDM 898298

N. 450/anno Circuiti per circolazione extracorporea
 cod. C20504 DIDECO PERFUSION TUBING SYSTEMS P.H.I.S.I.O.

confezionamento n. 1 pz. per confezione
 numero confezioni per anno: n. 450 confezioni per anno
costo unitario Euro 212,72/cad. +IVA 22%
 costo a confezione Euro 212,72/+IVA 22%
 codice CND C03010104
 RDM 517416

N. 2 sistemi per circolazione extracorporea modulari, nuovi di fabbrica, MOD. S5, ciascuno composto da:

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE
1	48-40-00	S5 Console 4 posizioni
1	48-41-10	S5 mensola a 4 posizioni
3	10-80-00	S5 pompa roller150 (S5 RP150)
3	10-81-30	Clamp tubi "Variolock" S5 RP150 (comprende 1 x 10-61-72 e 1 x 10-61-73)
1	10-84-60	S5 vassoio per pompa roller RP150
1	10-84-64	S5 vassoio per 2 pompe roller RP150
1	50-80-60	S5 2 pompe roller a stativo 85 (S5 MRP85) comprensive di fissaggio a stativo per 2 MRP85 e pannello di controllo
1	60-00-60	Sistema cp5, comprende i codici: 60-01-00, 60-02-50, 60-01-50, 96-414-120
1	28-95-01	S5 pannello di sistema da 5 display
5	28-95-10	S5 Modulo di controllo e display
1	22-20-20	S5 modulo sensore di pressione (2-canale)
3	45-04-03	Trasduttore di pressione MEDEX MX 960 LogiCal
3	45-04-15	Cavo di connessione per trasduttore di pressione
2	45-04-16	Supporto per un trasduttore di pressione
1	45-04-17	Supporto per 2 trasduttori di pressione
1	21-15-00	S5 Timer (3 canali), compresi nell'unità di base
1	20-30-20	S5 Modulo sensore temperatura (4 canali) per sonde YSI
2	042229000	Sonda di temperatura YSI per ossigenatori
1	23-40-00	S5 Modulo sensore di livello che comprende: 23-27-40 e 23-27-41
1	23-45-00	S5 Modulo sensore di bolle, incl. 23-07-45, 23-26-96 e 96-06-10
1	27-80-20	S5 Modulo sensore cardioplegia
1	96-490-042 ITA	Gas Blender meccanico Sechrist, Air+O2, FIO2
1	12-80-00	S5 Occlusore Venoso Elettrico (EVO), completo, che comprende:
1	35-05-70	S5 Lampada a led

1	24-90-80	Connect Recorder per S5/C5 (SW e Licenza - interfaccia, Data Pad, supporto e cavi)
---	----------	--

per il funzionamento dei due sistemi gestione dati, sarà fornito il seguente software:

1	24-90-45	Connect Manager (solo SW)
---	----------	---------------------------

n. 2 gruppi caldo-freddo, nuovi di fabbrica, MOD. 3T, ciascuno composto da:

1	16-02-80	Gruppo caldo freddo 3T (230 VOLT) con cavo 6 m (45-12-01) per connessione a S5
1	16-10-10	Raccordi per materassino
1	16-10-55	Tubing set for heating-cooling blankets
3	196CPC	Blanket
4	09028	Attacco Hansen femmina
4	09029	Attacco Hansen maschio
20	09035	tubo retinato

Costo annuo complessivo della fornitura (fornitura del sistema comprensivo di manutenzione e materiale di consumo: € 182.040,00 (IVA esclusa)

Costo totale della fornitura per 5 anni: € 910.200,00 (IVA esclusa)

Tempi di consegna sistemi e materiale di consumo: sistemi per circolazione extracorporea: 4 settimane data aggiudicazione; materiale di consumo: pronta e/o su vs. richiesta;

- DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato ed accettato dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- DI DARE ATTO che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei requisiti generali di partecipazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, mediante utilizzo del sistema AVCpass, tramite il PASSOE, e la stipula del relativo contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del provvedimento non trovando applicazione nella fattispecie la clausola di sospensione (cd. "standstill o termine dilatorio) prevista dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
- DI STABILIRE l'importo della cauzione definitiva da richiedere all'impresa aggiudicataria della presente fornitura, ai sensi dell'art. 12 del capitolato speciale di gara, in base al disposto dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, calcolata sul 10% dell'importo contrattuale complessivo I.V.A. esclusa:


DITTA	IMPORTO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA	CAUZIONE DEFINITIVA	MODALITA' STIPULA CONTRATTO
LIVA NOVA - SORIN GROUP ITALIA SRL	€ 910.200,00	€ 91.020,00	Scrittura privata

- DI PRECISARE, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di acquisto in quanto non risultano attive convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto, né contratti di fornitura derivanti dall'effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale (S.C.R. Spa);

7. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'affidamento della fornitura in oggetto, pari a complessivi € 910.200,00 (I.V.A. esclusa), verrà contabilizzata sui competenti conti di bilancio aziendale per quanto concerne la fornitura del materiale di consumo dedicato ai sistemi diagnostici in oggetto, il servizio di manutenzione di tipo "Full Risk con apparecchiatura critica sostitutiva" dei sistemi installati, l'aggiornamento hardware/software delle strumentazioni e l'attività di formazione del personale, e suddivisa negli esercizi di competenza, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo delle apparecchiature che verrà effettuato secondo le modalità indicate all'art. 16 del capitolato speciale di gara ("Consegna, installazione, collaudo e corso di formazione delle apparecchiature");
8. DI AUTORIZZARE il Direttore della S.C. Acquisti e Servizi Economici alla stipula del contratto relativo alla presente fornitura per l'ASO AL, che avverrà sotto forma di scrittura privata;
9. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'avviso di gara esperita ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. nr. 50/2016, secondo le modalità ivi stabilite, ed in base al preventivo nr. AR-0271/17 del 28/03/2017, depositato agli atti della S.C. proponente, formulato dalla ditta CSA MED srl di Cremona, già affidataria dell'incarico di pubblicazione degli avvisi legali della presente procedura di gara, su "La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee" e su "La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" e dell'estratto dell'avviso sui quotidiani: "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (inserzione gratuita); Italia Oggi; Il Giornale del Piemonte, Il Piccolo" per un importo di € 862,23 (IVA esclusa) che sarà posto a carico della stazione appaltante sul conto economico 3.10.04.50 "pubblicità su quotidiani e periodici";
10. DI DISPORRE, inoltre, che l'avviso di esito gara relativo alla presente procedura verrà pubblicato sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici e sul profilo del Committente (www.ospedale.al.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di garantirne la massima pubblicità.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Giovanna BARALDI




Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Altresì

DELIBERA

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n. 10 del 24.01.1995, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Giovanna BARALDI

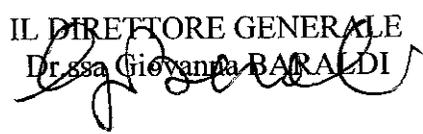

REGIONE PIEMONTE

A.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" - ALESSANDRIA

§ § § § §

Verbale di ammissione delle Ditte partecipanti alla procedura aperta comunitaria per l'affidamento della fornitura, in service, di nr. due sistemi per la circolazione extracorporea per la S.C. Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera, comprensivi del materiale di consumo e del servizio di assistenza tecnica, per la durata di anni cinque.

L'anno 2017, addì 24, del mese di febbraio, alle ore 10.00 ca., presso la sala riunioni della S.C. Acquisti e servizi economici dell'A.O. "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n. 30, si è riunito il seggio di gara così costituito:

Presidente:

Dott.ssa CRISTINA CABIATI, Direttore S.C. Acquisti e servizi economici;

Testimoni noti, richiesti ed idonei:

- Sig. Gianluigi CAMMARATA, Coadiutore Amministrativo presso la S.C. Acquisti e servizi economici;

- Dott. GIANLUCA MIGLIETTA, Collaboratore Amministrativo Esperto presso la S.C. Acquisti e servizi economici, Responsabile Unico del Procedimento e segretario verbalizzante.

I componenti del Seggio di gara dichiarano l'inesistenza delle cause di astensione previste dall'art. 42 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.

E' altresì presente il Sig. Massimiliano Marengo, il quale dichiara di presenziare per la Ditta LIVA NOVA - SORIN GROUP ITALIA SRL ed esibisce delega a firma del legale rappresentante.

IL PRESIDENTE

premette e dichiara

- che con Deliberazione DG. nr. 1457 del 23.12.2016 veniva indetta gara comunitaria, a procedura aperta, per l'affidamento della fornitura, in service, di nr. due sistemi per la circolazione extracorporea per la S.C. Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliera, comprensivi del materiale di consumo e del servizio di assistenza tecnica, per la durata di anni cinque.
- che sempre con la deliberazione n. 1457/2016 sono stati approvati i seguenti documenti:
 - bando di gara;
 - estratto del bando di gara;
 - capitolato speciale di gara e relativi allegati;
 - schema di offerta.
- che con la sopra richiamata determinazione si disponevano, altresì, le modalità di pubblicazione del bando di gara e dell'estratto al bando di gara.
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici, sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sull'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

- che l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI; ITALIA OGGI; IL GIORNALE DEL PIEMONTE, LA STAMPA - EDIZ. ALESSANDRIA;
- che gli atti di gara sono stati pubblicati sul "profilo del committente" dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.
- che il termine fissato per la presentazione delle offerte economiche è scaduto in data 22/02/2017, ore 12,00.


Tutto ciò premesso

Il Presidente della gara dichiara aperta la seduta, avverte che da questo momento le offerte pervenute non possono essere più ritirate e che non sono valide altre offerte sostitutive o integrative.

L'aggiudicazione della fornitura avverrà definitivamente ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, a lotto unico, a favore della Ditta che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, come prescritto dall'art. 9 del capitolato speciale.

L'Azienda Ospedaliera procederà all'aggiudicazione della presente fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida ai sensi del richiamato capitolato speciale; l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Presidente, a questo punto, constata che entro il termine di scadenza stabilito nel bando di gara è pervenuta l'offerta della seguente Ditta: LIVA NOVA - SORIN GROUP ITALIA SRL, Via Statale 12 Nord, 86 -



41037 Mirandola (MO) (prot. arrivo nr. 3608 del 21/02/2017).

Il Presidente procede, quindi, all'apertura del plico dell'unica ditta offerente e stabilisce di aprire i plichi di cui sopra, di accertarne il contenuto e contestualmente di provvedere ad aprire le sole buste contenenti la documentazione amministrativa comprovante l'ammissibilità delle Ditte a proseguire la presente gara e di accertare infine la rispondenza dei documenti in esse contenute con quanto richiesto dall'art.6 del capitolato speciale.

Il Presidente apre nel seguente ordine i plichi pervenuti entro il termine prescritto e ne accerta il contenuto:

• Plico n. 1 Ditta LIVA NOVA – SORIN GROUP ITALIA SRL, contenente:

- 1) Busta documentazione per l'ammissione alla gara.
- 2) Busta documentazione tecnica.
- 3) Busta offerta economica.

All'atto delle operazioni di apertura i plichi sono stati contrassegnati all'esterno con il numero corrispondente e analogo contrassegno è stato apposto anche sulle tre buste in essi contenute. Sulle buste contenenti le offerte economiche è stata, inoltre, apposta la data odierna e la sigla dei componenti il seggio di gara.

Si dà atto che si è provveduto ad aprire le sole buste contenenti la documentazione amministrativa comprovante l'ammissibilità delle Ditte a proseguire la presente gara ed ha accertato la rispondenza da parte di tutte le Ditte dei documenti in esse contenuti con quanto richiesto nel capitolato speciale di gara.

Il Presidente dispone e si accolla l'onere di trasmettere i plichi chiusi
contenenti la documentazione tecnica alla costituenda Commissione
Giudicatrice per l'apertura degli stessi, in seduta pubblica, e per le
successive valutazioni ad essa deputate, mentre si fa carico di con-
servare e custodire i plichi con le offerte economiche, unitamente a
tutta la documentazione oggi esaminata, presso gli uffici del respon-
sabile del procedimento.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del proce-
dimento, li dichiara chiusi alle ore 10.20.

Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 5 facciate com-
prese le sottoscrizioni, viene letto alla presenza dei testi e così appro-
vato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

(Dott.ssa CRISTINA CABIATI)




I TESTIMONI

(Sig. Gianluigi CAMMARATA)

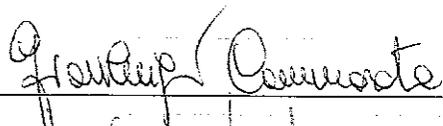

(Dott. GIANLUCA MIGLIETTA)





REGIONE PIEMONTE

A.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" - ALESSANDRIA

§ § § § §

Verbale di apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica fatta pervenire dalle Ditte partecipanti alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di nr. due sistemi per la circolazione extracorporea, comprensivi del materiale di consumo e del servizio di assistenza tecnica, per la S.C. Cardiochirurgia.

L'anno 2017, addì 14 del mese di marzo, alle ore 10.00 ca., presso la sala riunioni della S.C. Acquisti e servizi economici dell'A.O. "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n. 30, si è riunita la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nominata con Deliberazione DG. n. 306 del 08/03/2017, che risulta così composta:

Presidente:

Ing. Gianluca MAROCCO, Responsabile S.S. Ingegneria Clinica

Componenti:

Dott. Glauco CAMPORINI, Dirigente Medico S.C. Cardiochirurgia

Dott. Paolo DELLA PIETRA, Dirigente Medico S.C. Direzione Medica

Presidi Ospedalieri.

Segretario verbalizzante:

Dott. GIANLUCA MIGLIETTA, Collaboratore Amministrativo Esperto presso la S.C. Acquisti e servizi economici.

I componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico conferito con la citata deliberazione n. 306/2017, nonché l'inesistenza delle cause di conflitto di interesse e di astensione previste dall'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. , dall'art. 51 del codice di procedura civile e dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché di non aver subito condanne penali per i reati previsti nel capo I titolo II del libro secondo del Codice Penale (*Delitti contro la Pubblica Amministrazione*) anche con sentenza non passata in giudicato. E' altresì presente il Sig. Massimiliano Marengo, il quale dichiara di presenziare per la Ditta: LIVA NOVA – SORIN GROUP ITALIA SRL ed esibisce delega a firma del legale rappresentante.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

§ Richiama il verbale del seggio di gara redatto in data 24/02/2017, in seduta pubblica, con il quale si è proceduto all'ammissione alla procedura aperta comunitaria in oggetto dell'unica ditta partecipante: LIVA NOVA – SORIN GROUP ITALIA SRL;

§ Dichiarata aperta la seduta e prende atto che la Ditta summenzionata è stata convocata alla presente seduta con nota prot. nr. 5152 del 10.03.2017 trasmessa a mezzo PEC. Quindi, depone sul tavolo il plico contenente la documentazione tecnica della ditta summenzionata e stabilisce di aprire il plico di cui sopra al fine di verificare la corrispondenza della documentazione tecnica presentata rispetto a quanto dichiarato nell'elenco riepilogativo della stessa previsto dall'art. 6 lett. B) del Capitolato Speciale di gara.

La verifica della documentazione tecnica presentata ha dato esito posi-

tivo e la ditta viene pertanto ammessa alla fase successiva di valutazione.


Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 10.30 ca.

La data della seduta pubblica di apertura della busta contenente l'offerta economica verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e, nel frattempo, l'offerta tecnica viene custodita presso gli uffici della S.C. Acquisti e servizi economici, unitamente alla restante documentazione di gara.

Viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

Ing. Gianluca Marocco




I COMPONENTI

Dott. Glauco Camporini





Dott. Paolo Della Pietra



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Dott. Gianluca Miglietta

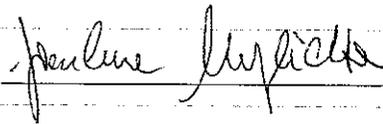



Fornitura di nr. 2 SISTEMI DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA per la S.C. Cardiocirurgia						
Fornitore		Sonn Group Italia s.r.l.				
Produttore		Sonn Group Deutschland GMBH				
Modello		S5				
<u>Caratteristiche funzionali - P.ti: 50</u>	<u>tecnico</u>	<u>peggio parziale</u>	<u>Criterio di assegnazione (SUFFICIENZA 26 P.TI)</u>	<u>Offerta</u>	<u>giudizi</u>	<u>punti</u>
B-1	Sistema modulare: indicare il numero massimo di pompe roller configurabili. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante prova pratica)	5	5 punti al sistema con le migliori caratteristiche, da 4 a 0 punti ai restanti in proporzione	L'apparecchiatura può essere dotata con un numero massimo di 7 pompe roller, intercambiabili facilmente, e due pompe centrifughe CP5. Due pompe roller di nuova concezione (150 mm o 85 mm di diametro) possono essere posizionate nelle immediate prossimità del paziente (Pag. 2 di "Scheda tecnica S5")	caratteristiche ottimali	5
B-2	Pompa roller: relazionare su flusso massimo, velocità massima (rpm) in funzione del diametro dei tubi, pressione massima in uscita. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante prova pratica)	5	5 punti al sistema con le migliori caratteristiche, da 4 a 0 punti ai restanti in proporzione	Su ogni pompa è possibile visualizzare il flusso con i seguenti range (Pag. 32 di "Scheda tecnica S5"): pompa grande pompa piccola 1/8" da 0 a 0,83 l/min da 0 a 0,44 l/min 3/16" da 0 a 1,79 l/min da 0 a 0,93 l/min 1/4" da 0 a 3,12 l/min da 0 a 1,57 l/min 5/16" da 0 a 4,70 l/min da 0 a 2,33 l/min 3/8" da 0 a 6,50 l/min o	caratteristiche ottimali	5
B-3	Pompa centrifuga: relazionare su volume priming, flusso massimo, velocità massima, pressione. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante prova pratica)	5	5 punti al sistema con le migliori caratteristiche, da 4 a 0 punti ai restanti in proporzione	Specifiche tecniche pompa centrifuga Revolution - Flusso max suggerito 8000 ml/min - Pressione max in uscita 800 mmHg (86,6 KPa / 0,67 bar / 9,7 psi) - Volume di riempimento 57 ml Dati tecnici sistema per pompa centrifuga CP5: Intervallo velocità max.: da 0 a 3500 rpm Velocità minima impostabile 300 rpm Precisione velocità ±10 rpm Precisione della misurazione flussi ±10% dal valore reale o ± 0,1 l/min Area di misurazione e visualizzazione pressione da -200 a +800 mmHg Risoluzione 1 mmHg Precisione dei valori di misurazione ±5 mmHg (Pag. 12 e 13 di "Scheda tecnica" S5)	caratteristiche ottimali	5
B-4	Misura di temperatura a 4 canali. Relazionare sul range di temperatura misurabile e la relativa precisione nella misurazione. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante prova pratica)	3	3 punti al sistema con le migliori caratteristiche, da 2 a 0 punti ai restanti in proporzione	Temperature: Display monitor della temperatura a 4 canali, che può essere impiegato per misurare e visualizzare fino a 4 valori di temperatura contemporaneamente (3 canali indipendenti ed 1 dedicato al controllo della cardioplegia). Possibilità di denominare il display. Dati tecnici: Range di temperatura: da 0°C a 50°C Precisione della misurazione: ± 0,2°C (Pag. 7 di "Scheda tecnica S5")	caratteristiche ottimali	3
B-5	Sensore bolle: relazionare sul range delle bolle d'aria rilevabili dal sistema. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante prova pratica)	3	3 punti al sistema con le migliori caratteristiche, da 2 a 0 punti ai restanti in proporzione	Sensore bolle: Il display visualizza il funzionamento del sensore di bolle, modificando simbolo e colore in caso di allarme. Il sensore è in grado di visualizzare l'attività di microbolle ed arrestare, in caso di allarme, la pompa abbinata. È possibile selezionare la dimensione delle bolle d'aria da rilevare. Possibilità di denominare il display. Dati tecnici: Range di dimensioni bolle: grande => 6 mm di diametro	caratteristiche ottimali	3

B-6	<p>Controllo Cardioplegia automatica e manuale. In modalità manuale, descrivere se possibile impostare separatamente i volumi, dose volumi di mandata in corso, dose cumulativa, tempo di somministrazione della dose cardioplegica, il tempo di ischemia. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante prova pratica)</p>	6	6 punti al sistema con le migliori caratteristiche, da 5 a 0 punti ai restanti in proporzione	<p>Controllo Cardioplegia: Il Display del controllo della cardioplegia, controlla l'applicazione di soluzioni cardioplegica, durante l'intervento chirurgico. È possibile scegliere tra due modalità di somministrazione: automatica o manuale. In questa seconda modalità è possibile impostare separatamente il volume della prima dose e delle dosi successive. I volumi somministrati sono visualizzati costantemente a display. È riportata sia la dose della mandata in atto (in modo incrementale o a volume sottratto, da 0,00 a 9,99 l) che la dose cumulativa, somma di tutte le mandate. Sul display è presente anche un timer che visualizza il tempo di somministrazione della dose cardioplegica ed il tempo di ischemia. Il modulo è in grado di controllare la somministrazione di cardioplegia eseguita con due pompe, previa impostazione dei relativi rapporti di flusso. Il display monitor della cardioplegia è provvisto di un collegamento indipendente con il sensore di bolle, di pressione e di temperatura. Possibilità di denominare il display. (Pag. 9 di Scheda tecnica S5")</p>	caratteristiche ottimali	6
B-7	<p>Occlusore venoso relazionare sui parametri impostabili (valore nominale dell'apertura dell'occlusore (valore compreso tra 0 e 100%); visualizzazione del valore reale dell'apertura dell'occlusore (in %); visualizzazione del valore nominale dell'apertura dell'occlusore (in %) durante una modifica; visualizzazione della calibrazione; visualizzazione della regolazione di precisione selezionata; visualizzazione della pompa assegnata. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica;</p>	2	2 punti al sistema con le migliori caratteristiche, da 1 a 0 punti ai restanti in proporzione	<p>L'occlusore venoso EVO viene utilizzato per la regolazione controllata del flusso sanguigno venoso di una perfusione extracorporea. Tutte le funzioni e i valori dell'occlusore venoso EVO sono impostabili e controllabili da questo elemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impostazione del valore nominale dell'apertura dell'occlusore (valore compreso tra 0 e 100%) - Visualizzazione del valore reale dell'apertura dell'occlusore (in %) - Visualizzazione del valore nominale dell'apertura dell'occlusore (in %) durante una modifica 	caratteristiche ottimali	2
B-8	<p>Gruppo caldo/freddo: preferibilmente dotato di n.3 serbatoi separati - n.3 circuiti indipendenti che possono essere usati singolarmente o contemporaneamente - n. 3 materassini termici per ciascun scambiatore di calore. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante prova pratica)</p>	10	10 punti al sistema con le migliori caratteristiche, da 9 a 0 punti ai restanti in proporzione	<p>Il gruppo caldo/freddo 3T permette di ottenere un'erogazione indipendente di acqua calda/fredda così da cambiare velocemente sia la temperatura del paziente che quella della soluzione cardioplegica. L'unità è dotata di 3 serbatoi separati per l'acqua e 3 circuiti indipendenti, che possono essere usati contemporaneamente o singolarmente. Il primo serbatoio regola la temperatura del paziente, attraverso due circuiti collegati, rispettivamente, all'ossigenatore e al materassino, che utilizzano la stessa temperatura impostata; il secondo e il terzo serbatoio sono dedicati al controllo della temperatura della cardioplegia e permettono di riscaldare/raffreddare la soluzione cardioplegica nel minor tempo possibile. I valori della temperatura dell'acqua calda e fredda possono essere pre-regolati ed i serbatoi possono essere utilizzati in qualsiasi momento durante l'operazione. Il sistema di riscaldamento/raffreddamento</p>	caratteristiche ottimali	10
B-9	<p>Sensore pressioni a due canali: misurazione e visualizzazione di valori di pressione positiva e negativa. Allarmi visivi e acustici. Possibilità di impostare un valore limite di arresto ed uno nominale. Indicare l'intervallo di funzionamento del sensore (mmHg/kPa). (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica; eventuale valutazione integrativa mediante prova pratica)</p>	5	5 punti al sistema con le migliori caratteristiche, da 4 a 0 punti ai restanti in proporzione	<p>Sensore pressioni: Sensore pressione a 2 canali, che possono essere impiegati per controllare due pompe, una indipendentemente dall'altra. Il controllo della pressione misura e visualizza valori di pressione positiva e negativa. È provvisto di allarmi visivi e acustici. Su Ogni canale è possibile impostare un valore limite di arresto ed uno nominale. Il controllo della pressione agisce arrestando la pompa se si raggiunge il valore pressorio prestabilito (limite di arresto). Nel caso in cui s'imposti il valore nominale, il canale della pressione agisce controllando e regolando la perfusione, in modo da fornire una pressione costante, pari al valore nominale, ottenuto adattando automaticamente la velocità della pompa. Il modulo display dedicato del quadro di controllo viene impiegato anche per impostare il riferimento zero ed il quadrano.</p>	caratteristiche ottimali	5



REGIONE PIEMONTE

A.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" - ALESSANDRIA

§ § § § §

Verbale di apertura delle offerte economiche ditte partecipanti alla procedura aperta comunitaria per l'affidamento della fornitura, in service, di nr. due sistemi per la circolazione extracorporea per la S.C. Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliera, comprensivi del materiale di consumo e del servizio di assistenza tecnica, per la durata di anni cinque.

L'anno 2017, addì 20 del mese di marzo, alle ore 14.00 ca., presso la sala riunioni della S.C. Acquisti e servizi economici dell'A.O. "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n. 30, si è riunita la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nominata con Deliberazione DG. n. 306 del 08/03/2017, che risulta così composta:

Presidente:

Ing. Gianluca MAROCCO, Responsabile S.S. Ingegneria Clinica

Componenti:

Dott. Glauco CAMPORINI, Dirigente Medico S.C. Cardiocirurgia

Dott. Paolo DELLA PIETRA, Dirigente Medico S.C. Direzione Medica

Presidi Ospedalieri.

Segretario verbalizzante:

Dott. GIANLUCA MIGLIETTA, Collaboratore Amministrativo Esperto presso la S.C. Acquisti e servizi economici.

E' altresì presente il Sig. Massimiliano Marengo, il quale dichiara di presenziare per la Ditta LIVA NOVA - SORIN GROUP ITALIA SRL ed esibisce delega a firma del legale rappresentante.

IL PRESIDENTE

premette e dichiara:

- che in data 24.02.2017 si sono svolte, in seduta pubblica, da parte del seggio di gara, le operazioni di apertura del plico contenente la documentazione amministrativa al fine della verifica di ammissibilità dell'unica ditta partecipante alla gara in oggetto: LIVA NOVA - SORIN GROUP ITALIA SRL, Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO);
- la Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 14.03.2017 ha proceduto all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica al fine della verifica della rispondenza alle specifiche indicate nel capitolato speciale di gara (art. 6 lett. B) ed ha successivamente effettuato in seduta riservata le operazioni di valutazione tecnica in base ai criteri stabiliti nel capitolato speciale così come risulta dalla relazione allegata al presente verbale, da cui risulta che i sistemi proposti sono corrispondenti alle specifiche tecniche di capitolato;
- con nota prot. nr. 5682 del 17.03.2017, è stata comunicata alla ditta ammessa, a mezzo PEC, la data di apertura, in seduta pubblica, della busta contenente l'offerta economica.

Preliminarmente, viene data lettura della relazione di valutazione tecnica che viene messa a disposizione, in visione.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Il Presidente procede, quindi, all'apertura della busta contenente l'offerta economica della ditta ammessa da cui risultano le seguenti quotazioni economiche:

Offerta nr. 10/2017 del 24/01/2017 - costo annuo del service (apparecchiature, materiale di consumo e servizio di assistenza tecnica): € 182.040,00 (oltre IVA) per un importo complessivo quinquennale di € 910.200,00 (oltre IVA).

Al termine delle predette operazioni, il Presidente dichiara l'aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara a favore della Ditta: LIVA NOVA - SORIN GROUP ITALIA SRL di Mirandola (MO).

Il Presidente ricorda, infine, che l'Azienda Ospedaliera ha la più ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte, riservandosi la possibilità di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi proposti fossero ritenuti non convenienti, mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta.

L'Azienda Ospedaliera non assumerà, pertanto, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito efficacia giuridica.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 14.30 e rimette la documentazione di gara al responsabile del procedimento per l'adozione dei successivi adempimenti di legge.

Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 4 facciate, com-

prese le sottoscrizioni, viene letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.


IL PRESIDENTE

Ing. Gianluca Marocco



I COMPONENTI

Dott. Glauco Camporini

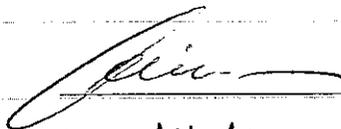


Dott. Paolo Della Pietra

Paolo Della Pietra

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Gianluca Miglietta

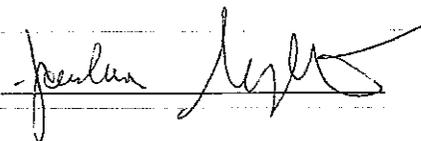

LivaNova

Health innovation that matters

Mirandola 24/01/2017
Ns. rif. LA/lc

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
S.C. ACQUISTI E SERVIZI ECONOMICI
Via Venezia, 16
15121 ALESSANDRIA AL

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI NR. DUE SISTEMI PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA PER LA S.C. CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA, COMPRENSIVI DEL MATERIALE DI CONSUMO E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.
N. GARA ANAC 6579116 – CIG 6875789095

La Ditta SORIN GROUP ITALIA s.r.l. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo Livanova Plc - Capitale Sociale € 8.550.034,00. – codice attività 266002 – sede legale in Milano (MI) - Via Benigno Crespi n. 17 – CAP 20159 – Tel. 02/69465.211 - Fax 02/69465.300 – sede amministrativa in Mirandola (MO) - Via Statale 12 Nord n. 86 - CAP 41037 – Tel. 0535/29811 – Fax 0535/25229 - Tel. Servizio Clienti Italia 02/37014960 - C.F. 10556980158 e P.I. 02109510368 n. iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano 10556980158 – REA N. 1767776 - pec: salesitaly.sorin@legalmail.it nella persona del suo Procuratore (vedasi procura Repertorio N. 12.312 – Raccolta N. 5.346 del 18/06/2013) e Business Line Manager, Italy, Cardiac Surgery Business Unit Leonardo Altiero, nato a Livorno (LI) il 05/11/1968 domiciliato per la carica in Via Benigno Crespi,17 – 20159 Milano presenta

OFFERTA N. 10/2017

N. 300/anno Ossigenatori a fibre cave per adulti
cod. 050714 MOD. INSPIRE 8

N. 450/anno Circuiti per circolazione extracorporea
cod. C20504 DIDECO PERFUSION TUBING SYSTEMS P.H.I.S.I.O.

Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of Livanova Plc

Sede Legale:
Via Benigno Crespi, 17 – 20159 Milano – Italy
Sede Amministrativa:
Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Stabilimenti:
Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Crescentino sn – 13040 Saluggia (VC) Italy
Tel. +39 0161 487.1 Fax +39 0161 487.681
Viale Cesare Cattaneo, 20 – 22063 Cantù (CO) Italy
Tel. +39 031 7370411 Fax +39 031 7370410

Sedi Commerciali:
Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Benigno Crespi, 17 – 20159 Milano – Italy
Tel. +39 02 69465.211 – Fax +39 02 69465.300

Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960
International Customer Service: +39 02 37027030

Capitale Sociale: € 8.550.034,00
Registro Imprese di Milano N. 10556980158
R.E.A. MILANO 1767776 – N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423
Cod. Fisc. 10556980158 – Part. IVA 02109510368
ISO CODE IT02109510368
Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000000823

www.livanova.com

20/3/17


PDP

LivaNova

Health innovation that matters

per l'utilizzo dei dispositivi sopra indicati saranno forniti in SERVICE:

n. 2 sistemi per circolazione extracorporea modulari, nuovi di fabbrica, MOD. S5 ciascuno composto da:

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE
1	48-40-00	S5 Console 4 posizioni
1	48-41-10	S5 mensola a 4 posizioni
3	10-80-00	S5 pompa roller150 (S5 RP150)
3	10-81-30	Clamp tubi "Variolock" S5 RP150 (comprende 1 x 10-61-72 e 1 x 10-61-73)
1	10-84-60	S5 vassoio per pompa roller RP150
1	10-84-64	S5 vassoio per 2 pompe roller RP150
1	50-80-60	S5 2 pompe roller a stativo 85 (S5 MRP85) comprensive di fissaggio a stativo per 2 MRP85 e pannello di controllo
1	60-00-60	Sistema cp5, comprende i codici: 60-01-00, 60-02-50, 60-01-50, 96-414-120
1	28-95-01	S5 pannello di sistema da 5 display
5	28-95-10	S5 Modulo di controllo e display
1	22-20-20	S5 modulo sensore di pressione (2-canale)
3	45-04-03	Trasduttore di pressione MEDEX MX 960 LogiCal
3	45-04-15	Cavo di connessione per trasduttore di pressione
2	45-04-16	Supporto per un trasduttore di pressione
1	45-04-17	Supporto per 2 trasduttori di pressione
1	21-15-00	S5 Timer (3 canali), compresi nell'unità di base
1	20-30-20	S5 Modulo sensore temperatura (4 canali) per sonde YSI
2	042229000	Sonda di temperatura YSI per ossigenatori
1	23-40-00	S5 Modulo sensore di livello che comprende: 23-27-40 e 23-27-41
1	23-45-00	S5 Modulo sensore di bolle, incl. 23-07-45, 23-26-96 e 96-06-10
1	27-80-20	S5 Modulo sensore cardioplegia
1	96-490-042 ITA	Gas Blender meccanico Sechrist, Air+O2, FIO2
1	12-80-00	S5 Occlusore Venoso Elettrico (EVO), completo, che comprende:
1	35-05-70	S5 Lampada a led
1	24-90-80	Connect Recorder per S5/C5 (SW e Licenza - interfaccia, Data Pad, supporto e cavi)

per il funzionamento dei due sistemi gestione dati, sarà fornito il seguente software:

1	24-90-45	Connect Manager (solo SW)
---	----------	---------------------------

Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of LivaNova Pic

Sede Legale:
Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italy
Sede Amministrativa:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Stabilimenti:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Crescentino sn - 13040 Saluggia (VC) Italy
Tel. +39 0161 487.1 Fax +39 0161 487.681
Viale Cesare Cattaneo, 20 - 22063 Cantù (CO) Italy
Tel. +39 031 7370411 Fax +39 031 7370410

Sedi Commerciali:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italy
Tel. +39 02 69465.211 - Fax +39 02 69465.300

Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960
International Customer Service: +39 02 37027030

Capitale Sociale: € 8.550.034,00
Registro Imprese di Milano N. 10556980158
R.E.A. MILANO 1767776 - N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423
Cod. Fisc. 10556980158 - Part. IVA 02109510368
ISO CODE IT02109510368
Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000000823

www.livanova.com

LivaNova

Health innovation that matters

n. 2 gruppi caldo-freddo, nuovi di fabbrica, MOD. 3T ciascuno composto da:

1	16-02-80	Gruppo caldo freddo 3T (230 VOLT) con cavo 6 m (45-12-01) per connessione a S5
1	16-10-10	Raccordi per materassino
1	16-10-55	Tubing set for heating-cooling blankets
3	196CPC	Blanket
4	09028	Atacco Hansen femmina
4	09029	Attacco Hansen maschio
20	09035	tubo retinato

P_{CONS} EURO 182.040,00/+IVA 22%
(euro centottantaduemilaquaranta/00)

COSTO ANNUO DEL MATERIALE DI CONSUMO
sopra indicato, comprensivo di:

- utilizzo di n.2 sistemi per circolazione extracorporea, MOD. S5 modulari, nella configurazione richiesta dal capitolato speciale completi di n. 2 gruppi caldo freddo MOD. 3T, nuovi di fabbrica,
- servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk

P_{TOT} EURO 910.200,00/+IVA 22%
(euro novecentodiecimiladuecento/00)

COSTO TOTALE DELLA FORNITURA PER 5 ANNI

a) Importo dei costi della sicurezza "propri": Euro 2.093,46 (0,23%) (euro duemilanovantatre/46)

Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of LivaNova Ptc

Sede Legale:
Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italy
Sede Amministrativa:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Stabilimenti:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Crescentino sn - 13040 Saluggia (VC) Italy
Tel. +39 0161 487.1 Fax +39 0161 487.681
Viale Cesare Cattaneo, 20 - 22063 Cantù (CO) Italy
Tel. +39 031 7370411 Fax +39 031 7370410

Sedi Commerciali:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italy
Tel. +39 02 69465.211 - Fax +39 02 69465.300

Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960
International Customer Service: +39 02 37027030

Capitale Sociale: € 8.550.034,00
Registro Imprese di Milano N. 10556980158
R.E.A. MILANO 1767776 - N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423
Cod. Fisc. 10556980158 - Part. IVA 02109510368
ISO CODE IT02109510368
Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000008923

www.livanova.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo LivaNova Ptc

LivaNova

Health innovation that matters

c) Dettaglio del costo dei consumabili (P_{CONS}):

ossigenatori a fibre cave per adulti:	cod. 050714 MOD. INSPIRE 8
confezionamento	n. 2 pz. per confezione
numero confezioni per anno:	n. 150 confezioni per anno
costo unitario	Euro 287,72/cad. +IVA 22% (euro duecentottasette/72)
costo a confezione	Euro 575,44/+IVA 22% (euro cinquecentosettancinque/44)
codice CND	C03010102
RDM	898298

circuiti per circolazione extracorporea:	cod. C20504
	DIDECO PERFUSION TUBING
	SYSTEMS PH.I.S.I.O.
confezionamento	n. 1 pz. per confezione
numero confezioni per anno:	n. 450 confezioni per anno
costo unitario	Euro 212,72/cad. +IVA 22% (euro duecentododici/72)
costo a confezione	Euro 212,72/+IVA 22% (euro duecentododici/72)
codice CND	C03010104
RDM	517416

d) Tempi di consegna

Sistemi per circolazione extracorporea : 4 settimane data aggiudicazione
Materiale di consumo: pronta e/o su vs. richiesta

e) Aliquota IVA: 22%

f) Importo minimo fatturabile : una confezione



Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of LivaNova Plc


Sede Legale:
Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italy
Sede Amministrativa:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Stabilimenti:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Crescentino sn - 13040 Sauggia (VC) Italy
Tel. +39 0161 487.1 Fax +39 0161 487.681
Viale Cesare Cattaneo, 20 - 22063 Cantù (CO) Italy
Tel. +39 031 7370411 Fax +39 031 7370410

Sedi Commerciali:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italy
Tel. +39 02 69465.211 - Fax +39 02 69465.300

Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960
International Customer Service: +39 02 37027030

Capitale Sociale: C 8.550.034,00
Registro Imprese di Milano N. 10556980158
R.E.A. MILANO 1767776 - N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423
Cod. Fisc. 10556980158 - Part. IVA 02109510368
ISO CODE IT02109510368
Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000000823

www.livanova.com



LivaNova


Health innovation that matters

g) Periodo di validità dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
- Resa CIP

h) Elenco dei migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie sul territorio nazionale:

- N.B.:**
- SORIN GROUP ITALIA srl ha effettuato la quasi totalità delle forniture di sistemi per circolazione extracorporea con contratti di vendita
 - I circuiti per circolazione extracorporea sono creati su specifiche indicazioni degli utilizzatori o su specifiche dei capitolati di gara pertanto non sono comparabili

Destinatario fornitura	Data fornitura	Tipologia contratto	q.ta' apparecchiature fornite	q.ta' annue materiale consumo	Prezzi del Materiale di consumo
Az.osp.Universitaria San Martino di Genova	2016	Fornitura in comodato d'uso di sistemi per circolazione extracorporea e fornitura in vendita dei disposables	n. 3	n.800 kit composti da : ossigenatore mod. INSPIRE 6F o mod. INSPIRE 8F e circuito per circolazione extracorporea	Euro 595,00/cad.+ IVA 22%

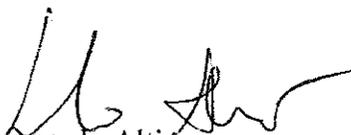
Leonardo Altiero
Sorin Group Italia s.r.l.
Procuratore e Business Line Manager, Italy,
Cardiac Surgery Business Unit

Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of LivaNova Plc


Sede Legale:
Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italy
Sede Amministrativa:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Stabilimenti:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Crescentino sn - 13040 Saluggia (VC) Italy
Tel. +39 0161 487.1 Fax +39 0161 487.681
Viale Cesare Cattaneo, 20 - 22063 Cantiù (CO) Italy
Tel. +39 031 7370411 Fax +39 031 7370410


Sedi Commerciali:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Benigno Crespi, 17 - 20159 Milano - Italy
Tel. +39 02 69465.211 - Fax +39 02 69465.300


Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960
International Customer Service: +39 02 37027030

Capitale Sociale: € 8.550.034,00
Registro Imprese di Milano N. 10556980158
R.E.A. MILANO 1767776 - N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423
Cod. Fisc. 10556980158 - Part. IVA 02109510368
ISO CODE IT02109510368
Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000000823
www.livanova.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo LivaNova Plc


PDF





Regione Piemonte
Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"
Alessandria


Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n. 400 del 05/04/2017 (ai sensi della D.G.R. n.42-1370 del 27/04/2015)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/04/2017

Alessandria, li 10/04/2017

Il Funzionario Incaricato
(dr. Fabrizio Ferrando)

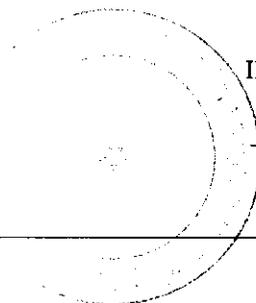

-
- Esecutiva dal: 05/04/2017
-

Trasmessa:

- Al Presidente Collegio Sindacale in data: 06/04/2017
Ai sensi art.14 L.R.n.10 del 24.1.1995
- Alla Giunta Regionale in data:
- Richiesta chiarimenti in data:
- Ricevuti chiarimenti in data: